



βステイック (β-TCP製人工骨)

PSシリーズ

知的財産権出願中
特願 2014-141788 他

細径のスリーブに円柱形状のβ-TCPが装填され、狭深部への補填が行えます。

補填作業のイメージ図

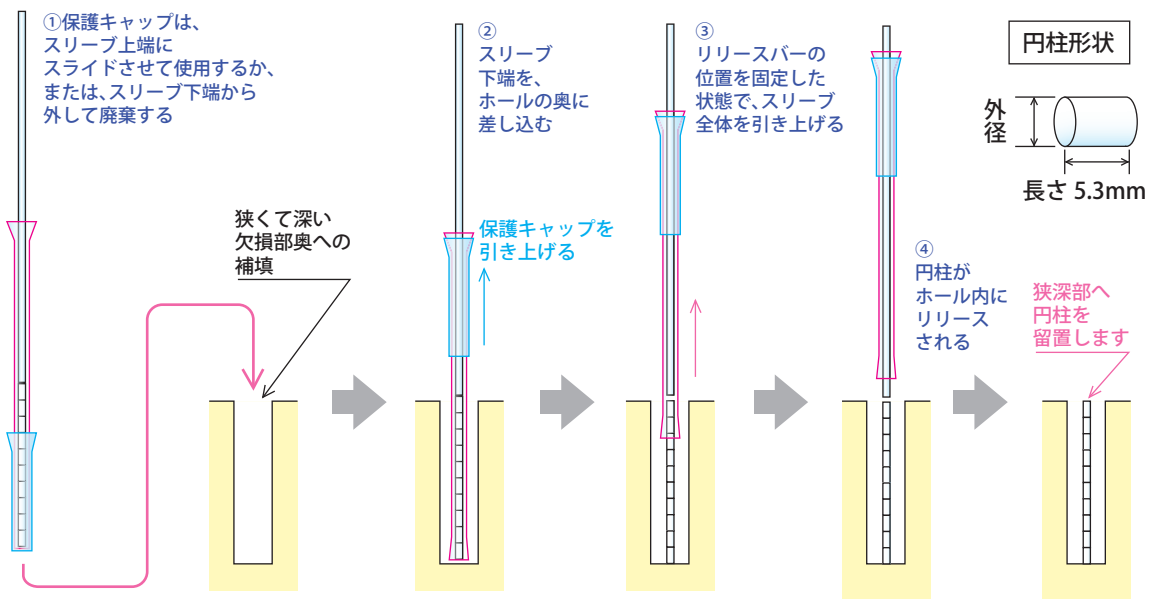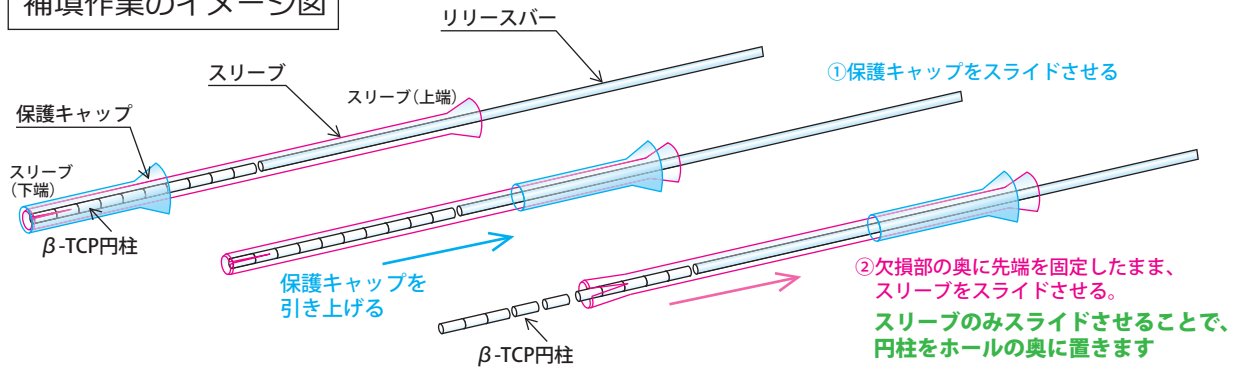

骨補填材 B2 PSシリーズ製品一覧 【気孔率75%】

形状	ブロック体
圧縮強度	0.9MPa以上

品番	品名	寸法			容量 mL	JANコード	区分名:略称
		スリーブ径	円柱(φ×Lmm)	個数×本数			
KM124900	骨補填材 B2 PS-25-2	φ3	(φ2.2×5.3mm)	10ヶ×2本入り	0.40mL	4571393192345	人工骨: AB-06
KM120800	骨補填材 B2 PS-25-8	φ3	(φ2.2×5.3mm)	10ヶ×8本入り	1.60mL	4571393192192	人工骨: AB-06
KM125000	骨補填材 B2 PS-35-2	φ4	(φ3.2×5.3mm)	10ヶ×2本入り	0.85mL	4571393192352	人工骨: AB-06
KM120900	骨補填材 B2 PS-35-6	φ4	(φ3.2×5.3mm)	10ヶ×6本入り	2.55mL	4571393192208	人工骨: AB-06
KM125100	骨補填材 B2 PS-45-2	φ5	(φ4.5×5.3mm)	10ヶ×2本入り	1.69mL	4571393192369	人工骨: AB-06
KM121000	骨補填材 B2 PS-45-4	φ5	(φ4.5×5.3mm)	10ヶ×4本入り	3.38mL	4571393192215	人工骨: AB-06

販売名: 骨補填材 B2
承認番号: 22200BZX00902000
医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器
吸収性骨再生用材料



製造販売元
株式会社カタリメディック
〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25
ベンチャープラザ船橋
TEL 047-409-1616